

فصل اکسیژن تراپی:

## اهداف

پس از پایان این دوره از فرا گیران انتظار می رود

- ۱- با فیزیولوژی تنفس آشنا گردند.
- ۱- هیپوکسی و هیپوکسمی را از یکدیگر افتراق دهند.
- ۱- انواع هیپوکسی را نام ببرند.
- ۴- عوارض اکسیژن درمانی را توضیح دهند.
- ۵- روشهای اکسیژن درمانی را نام ببرند.
- ۶- ابزارهای مختلف جهت اکسیژن درمانی را با توجه به وضعیت بیمار به کار برند.
- ۷- اهداف اکسیژن درمانی در نوزادان را شرح دهند.
- ۸- قسمت‌های تشکیل دهنده پالساکسیمتری را نام ببرند.
- ۹- نحوه کار با دستگاه پالس اکسیمتری را توضیح دهند.

## تنفس

بدن انسان جهت سوخت و ساز و انجام فعالیتها و تولید انرژی به اکسیژن نیاز دارد. اهداف تنفس فراهم کردن اکسیژن و برداشت دی اکسید کربن از بافتها است. در واقع تنفس به معنای تبادل گازی در سطح آلوئولهای ریوی (تنفس خارجی) و در سطح سلولی (تنفس داخلی) میباشد. گاهی اوقات تنفس روند معمول خود را از دست داده و عملکرد و تبادل گازها دچار اختلال می شود که نیازمند مراقبت درمانی می شود .

## فیزیولوژی تنفس

گازهایی که در فیزیولوژی تنفس اهمیت دارند، مولکولهای ساده‌ای هستند که میتوانند آزادانه و بطور تصادفی در میان یکدیگر حرکت نمایند. فرایند مربوط به حرکت اکسیژن و دی اکسید کربن بین آلوئولها و خون، و مابین خون و سلولهای بدن بر مبنای قانون انتشار است. انتشار به معنی حرکت تصادفی مولکولها از یک ناحیه با غلظت یا تراکم بیشتر به ناحیه ای با غلظت یا تراکم کمتر است. لازمه انتشار، انرژی است که بوسیله جنبش ذاتی و حرکت خود مولکولها تامین می شود. برخورد دائمی مولکولهای دارای حرکت جنبشی به سطحی که در آن قرار دارند موجب وارد آمدن نیرو یا فشار به سطح مربوطه می شود، بنابراین فشار وارد شده به سطوح مختلف مجاری تنفسی و آلوئولهای ریوی متناسب با مجموع نیروهای وارد توسط کلیه مولکولهایی است که در هر لحظه معین با این سطح برخورد می نمایند. این بدان معنی است که فشار هر گاز در یک مخلوط گازی متناسب با این میزان درصد گاز در آن مخلوط گازی است (قانون دالتون). در یک مخلوط گازی، سرعت انتشار هر یک از گازها نسبت مستقیم با فشار ناشی از هر یک از گازهای متشکله آن (به تنهایی) دارد که به آن فشار نسبی یا سهمی آن گاز اطلاق می شود. مثلاً  $PO_2$  به معنی فشار نسبی گاز اکسیژن است. ترکیب تقریبی هوای اتمسفر شامل ۷۹٪ نیتروژن و ۱۱٪ اکسیژن است. فشار اتمسفر در سطح دریا حدود ۷۶۱ میلی متر جیوه است. از آنجایی که سهم هر گاز در فشار کلی نسبت مستقیم با غلظت آن گاز دارد بنابراین در حدود ۷۹٪ از ۷۶۱ میلی متر جیوه (۶۱۱ میلی متر جیوه) به وسیله نیتروژن و در حدود ۱۱٪ از ۷۶۱ میلی متر جیوه (۱۶۱ میلی متر جیوه) بوسیله اکسیژن ایجاد می شود.

زمانی که هوا وارد تراشه میشود، بخار آب اشباع میگردد. بخار آب حدود ۴۷ میلی متر جیوه از فشار اتمسفر میکاهد، بنابراین فشار گاز در ریه ۷۱۱ میلی متر جیوه خواهد بود، که سهم گازهای مختلف در ایجاد این فشار شامل نیتروژن ۵۶۹ میلی متر جیوه، اکسیژن ۱۱۴ میلی متر جیوه و دی اکسید کربن ۴۱ میلی متر جیوه است.

زمانی که یک گاز به محلولی برخورد میکند در آن حل می شود، میزان حل شدن گازها به قابلیت حلالی و فشار آنها مربوط است، مثلاً قابلیت حل شدن CO<sub>2</sub> در آب ۱۱ برابر بیشتر از اکسیژن است. انتقال گاز در سطح آلوئولها و بافتها توسط انتشار صورت می-گیرد در سطح آلوئولی -کاپیلری، مسیری که بایستی گاز از خلال آن عبور نماید شامل سطح داخل آلوئولی، اپیتلیوم آلوئولی، لایه‌های از پلازما و غشاء گلبول قرمز است. میزان انتشار گازها، بستگی به اختلاف فشار نسبی گازها در آلوئولها و خون کاپیلرهای عروق ریوی دارد. این گرادیان فشار، در واقع نیروی راننده‌های است که موجب انتقال گاز در طول غشاء آلوئولی کاپیلری میشود.

## انتقال اکسیژن در خون

اکسیژن به محض انتشار از آلوئولها به داخل مویرگهای ریوی، عمدتاً با هموگلوبین ترکیب شده، به مویرگهای بافتی منتقل شده و در آنجا برای استفاده سلولها آزاد می شود. بطور کلی اکسیژن به دو صورت در خون حمل می شود:

۱- بصورت محلول در پلازما (PO<sub>2</sub>)

۱- بصورت ترکیب با هموگلوبین (O<sub>2</sub>Sat)

در شرایط طبیعی فیزیولوژیکی تقریباً ۹۷٪ اکسیژن دریافتی از ریهها از طریق ترکیب با هموگلوبین به بافتها منتقل میشود، مقدار باقی مانده بصورت محلول در خون حمل میگردد که میزان آن متناسب با فشار نسبی اکسیژن خون شریانی است. (به ازای هر یک میلی-متر جیوه فشار نسبی اکسیژن ۱۱۱.۱ میلی لیتر اکسیژن در هر ۱۱۱ میلی لیتر خون به صورت محلول در می آید. بنابراین خون شریانی در حالت طبیعی با فشارنسبی اکسیژن برابر با ۱۱۱ میلی متر جیوه محتوی ۱۰.۱ میلی لیتر اکسیژن در هر ۱۱۱ میلی لیتر خون است.) گرچه تنها بخش کوچکی از کل اکسیژن حمل شده در خون بصورت محلول در پلازما است لیکن این بخش از اکسیژن محلول نقش بسزایی در اکسیژناسیون سلولی دارد، زیرا فشار اعمال شده توسط اکسیژن محلول در پلازما، عامل موثر در ترکیب اکسیژن با هموگلوبین و انتقال آن به بافتها است. در جایی که میزان Pao<sub>2</sub> بالا باشد) مثلاً در مویرگهای ریوی( بلافاصله اکسیژن با هموگلوبین ترکیب میشود، برعکس در جایی که میزان Pao<sub>2</sub> پایین باشد) مثلاً در مویرگهای بافتی پس از تبادل با سلول(، اکسیژن از هموگلوبین جدا شده و بواسطه اختلاف فشار از مویرگهای بافتی عبور کرده و به داخل سلول منتشر میشود. بنابراین برای شروع روند جدا شدن اکسیژن از هموگلوبین و انتشار آن به داخل سلول بایستی میزان Pao<sub>2</sub> بیشتر از سطح فشار نسبی اکسیژن داخل سلولی باشد. افزایش درجه حرارت و انجام فعالیتهای ماهیچه‌های از عوامل مهم دیگر در افزایش آزاد شدن اکسیژن از هموگلوبین است. هموگلوبین یک پروتیین مرکب است. قسمت هم یک ترکیب پورفیرینی آهن دار است که به پروتیین گلوبولین که از چهار زنجیره پلیپتیدی تشکیل شده، متصل میگردد. بنابراین هر مولکول هموگلوبین دارای چهار زنجیره پپتیدی و هر زنجیره به یک ترکیب هم متصل است. اکسیژن بطور اختصاصی

با اتم هم موجود در قسمت هم ترکیب می شود. بنابراین هر مولکول هموگلوبین قادر به اتصال با ۴ اتم اکسیژن است. در صورتیکه ۴ اتم آهن در هر مولکول هموگلوبین با اکسیژن باند شود گفته می شود که مولکول هموگلوبین بطور کامل اشباع شده است.

منظور از اشباع درصد اشغال محللهای اتصال اکسیژن به هموگلوبین توسط اکسیژن است. هموگلوبین باند شده با اکسیژن را اکسی-هموگلوبین مینامند. زمانی که مولکول هموگلوبین با اکسیژن ترکیب نشده باشد به آن هموگلوبین احیا شده (Deoxyhemoglobin)

### انتقال CO2 در خون

CO2 یکی از محصولات نهایی متابولیسم هوازی داخل سلولی است که در جریان اعمال سلولی مقادیر متنابهی تولید شده و از سلولها به داخل جریان خون انتشار می یابد. حمل آن در خون به سه شکل است:

۱- بصورت محلول در پلاسما (PaCO2)

در حدود ۱۱٪ CO2 به صورت محلول در خون حمل می شود زیرا CO2 در پلاسما محلول میباشد.

۱- بصورت یون بیکربنات

۱- بصورت ترکیب با هموگلوبین (Carbominohemoglobin)

### هایپوکسی و هایپوکسمی

هایپوکسمی عبارت است از کاهش میزان اکسیژن خون شریانی است و زمانی که این کاهش اکسیژن در سطح سلولی منجر به کاهش اکسیژناسیون بافتی گردد، اصطلاحاً به آن هایپوکسی گفته می شود.

اندازهگیری هایپوکسی نسوج غیرممکن است، زیرا در قسمتهای مختلف بدن میزان آن بسیار متفاوت است. میزان طبیعی اکسیژن خون شریانی ۸۱ تا ۱۱۱ میلی متر جیوه است .

بدن نسبت به هایپوکسی بوسیله افزایش تعداد و عمق تنفس، که تلاشی جهت تهویه بیشتر آلوئولی است واکنش نشان میدهد. در نتیجه علائم تنگی نفس بصورت استفاده از عضلات کمک تنفسی، تعریق و سیانوز ظاهر میگردد. با افزایش تلاش و تقای تنفسی، میزان مصرف اکسیژن نیز بیشتر شده منجر به ایجاد یک سیکل معیوب که نتیجه آن خستگی و احتمالاً ایست تنفسی است. با رساندن اکسیژن به بیمار، از میزان هایپوکسی کاسته شده، نیاز به کوشش برای تنفس برطرف می گردد و الگوی طبیعی تنفس از سر گرفته می شود.

در سیستم گردش خون، زمانی که بدن دچار هایپوکسمی شود، قلب جهت جبران کمبود اکسیژن، برون ده خود را افزایش میدهد .

بدلیل بالا رفتن بار کاری قلب در ضمن هایپوکسمی، تجویز اکسیژن در بیمارانی که دچار مشکلات قلبی نظیر MI, CHF, IHD هستند ضرورت دارد.

بطور کلی نشانه‌های بالینی هایپوکسمی شامل تغییر در وضعیت ذهنی (نظیر اختلال در قضاوت، خواب آلودگی شدید و کما) تنگی نفس، افزایش فشارخون، تغییر در ضربان قلب، آریتمی، سیانوز (از نشانه‌های دیررس)، تعریق شدید و سردی انتهایهاست.

هایپوکسمی معمولاً به هایپوکسمی منتهی میشود (کاهش تحویل اکسیژن به بافتها)، نشانه‌ها و علائم هایپوکسمی بستگی به سرعت بروز هایپوکسمی دارد. هایپوکسمی ناگهانی با تغییر در عملکرد CNS همراه است زیرا مرکز عصبی بیشتر از سایر بافتها نسبت به کاهش اکسیژن حساسیت دارند بدین ترتیب بیمار دچار ناهماهنگی حرکات و اختلال در قضاوت میشود. تابلوی بالینی بیمار مشابه یک فرد مست است.

هایپوکسمی مزمن (مثلاً در COPD و CHF) موجب خستگی و خواب آلودگی، بیثباتی، بی‌توجهی و تاخیر در رفلکسها میشود. نیاز به تجویز اکسیژن، با آزمایش ABG و ارزیابی بالینی مورد بررسی قرار میگیرد.

## انواع هایپوکسمی

عوامل متعددی میتوانند منجر به هایپوکسمی و در نهایت هایپوکسمی بافتی می شوند. بر این اساس میتوان هایپوکسمی را به چند دسته تقسیم نمود:

### ۱- هایپوکسمی هایپوکسمیک Hypoxemic H

زمانی که به هر دلیل درصد اکسیژن هوای دمی کاهش یابد، هایپوکسمی هایپوکسمیک ایجاد خواهد شد. تنفس در ارتفاعات و کاهش اکسیژن تنفسی به هر دلیل میتواند عامل ایجاد این نوع هایپوکسمی باشد. این حالت با افزایش تهویه آلوئولی و تجویز اکسیژن برطرف می شود.

### ۲- هایپوکسمی رکودی Stagnatic H

این نوع هایپوکسمی بدنبال رکود خون و یا کند شدن جریان خون در بیماریهایی نظیر آرترواسکلروز، آترواسکلروز، ترومبوز، MI, CHF ایست قلبی-ریوی و انواع شوکها ایجاد می شود. این نوع هایپوکسمی توسط اقداماتی نظیر اصلاح حجم مایعات، تجویز داروهای محرک قلب و تنگ کننده عروق و احیای قلبی-ریوی قابل درمان است.

### ۳- هایپوکسی آنمیک Anemic H

این نوع هایپوکسی بدلیل کاهش غلظت هموگلوبین و یا در نتیجه کاهش ظرفیت حمل اکسیژن توسط هموگلوبین به بافتها ایجاد می شود. انواع آنمیها، مسمومیت با گاز CO و متهموگلوبینمی از عوامل بروز آن هستند. این نوع هایپوکسی توسط ترانسفوزیون خون و تجویز اکسیژن با فشار بالا قابل درمان است.

### ۴- هایپوکسی سمی Histotoxic H

در این نوع هایپوکسی، اختلال در سطح سلولی و بصورت اشکال در انتقال اکسیژن به داخل سلولها است. در مسمومیت با سیانور، درمان شامل تجویز تیوسولفات سدیم و در اورمی، شامل دیالیز است.

### ۵- هایپوکسی ناشی از کاهش p50

کاهش p50 منجر به شیفت منحنی شکست اکسی هموگلوبین به سمت چپ و بروز آلکالوز میگردد و آلکالوز از مواردی است که سبب قویتر شدن میل ترکیبی اکسیژن به هموگلوبین میشود. بنابراین زمانی که اکسیهموگلوبین به سطح سلولی میرسد، اکسیژن خود را رها نمی کند و این مسئله منجر به بروز هایپوکسی در سطح بافتی می گردد. درمان شامل تصحیح آلکالوز است.

### ۶- هایپوکسی ناشی از افزایش نیاز

این نوع هایپوکسی بدنبال وضعیتهای که منجر به افزایش نیازهای متابولیک در بدن می شود بوجود میآید. شایعترین علت آن سوختگی شدید و تیروتوکسیکوز است. درمان عبارت از رفع علت اولیه است.

## اکسیژن درمانی

در اکسیژن درمانی، گاز اکسیژن را با فشار بیش از آنچه در اتمسفر محیطی وجود دارد به بیمار میرسانند (بیش از ۱۱٪). با تجویز اکسیژن و درمان هایپوکسمی، می توان از هایپوکسی بافتی جلوگیری کرد. هدف از اکسیژن درمانی شامل کاهش کار تنفسی و برداشتن فشار از روی میوکارد است. انتقال اکسیژن به بافتها به عواملی نظیر برون ده قلبی، اکسیژن موجود در خون شریانی، غلظت هموگلوبین و نیازهای متابولیکی بستگی دارد که در هنگام تجویز اکسیژن باید تمام عوامل مذکور را در نظر داشت. میزان کاهش اکسیژن خون از طریق ABG، اکسیمتری نبض و علائم بالینی مشخص می شود.

## ملاحظات بالینی در اکسیژن درمانی

تجویز اکسیژن باید با رعایت احتیاط انجام شده و اثرات آن بر روی بدن مورد ارزیابی قرار گیرد. پیش از به کارگیری اکسیژن علائم حیاتی را کنترل کرده و در طول درمان ادامه دهید. برای کنترل سطوح اکسیژن لازم است به طور مداوم یا متناوب از پالساکسیمتر استفاده شود و اکسیژن را به صورت مرطوب به کار برید. اکسیژن یک داروست، لذا جز در موارد اورژانس باید با نظر پزشک استفاده شود، اگر به موقع و به نحو صحیح تجویز شود مفید خواهد بود. در غیر اینصورت میتواند عوارضی را بدنبال داشته باشد. بیمار را از نظر سابقه بیماریهای مزمن ریوی مورد بررسی قرار دهید در مبتلایان به بیماریهای ریوی، اکسیژن درمانی با هدف رساندن  $Pao_2$  شریانی به میزان ۶۱-۸۱ میلیمتر جیوه است. در این محدوده ۹۱-۸۱ درصد هموگلوبین از اکسیژن اشباع میشود (با افزایش تجویز اکسیژن نمیتوان درصد اشباع هموگلوبین را افزایش داد).

هنگام تجویز اکسیژن لازم است بیمار را از نظر نیاز به اکسیژن بررسی نمود. علائم مورد نظر شامل اختلالات ذهنی، اختلال در سطح هوشیاری، رنگ غیر طبیعی پوست و مخاطها، تعریق شدید، تغییر در فشارخون، تاکیکاردی و تاکیپنه است.

بدلیل قابلیت احتراق اکسیژن هنگام استفاده همیشه باید خطر آتشسوزی را مد نظر قرار داد و از استعمال دخانیات در محیط اجتناب نمود.

## عوارض اکسیژن درمانی

۱- هیپوونتیلیاسیون ناشی از اکسیژن

مه‌های مراکز تنفسی بطور طبیعی در اثر افزایش نف تته رهنگام استفاده از  $Pao_2$  صورت می گیرد. مراکز حساس به فشار اکسیژن خون شریانی موجود در آئورت و کاروتید بوسیله کاهش  $Pao_2$  فعال میشوند ( $Pao_2$  کمتر از ۶۱ ملیمترجیوه). در بیمارانی که دچار اختلالات مزمن ریوی همراه با احتباس  $CO_2$  هستند تدریجاً حساسیت مراکز تنفسی به افزایش  $Paco_2$  از بین رفته، تحریک تنفسی تنها بواسطه تغییر در سطح  $Pao_2$  صورت میگیرد. در چنین افرادی، تجویز زیاد اکسیژن با مقدار کنترل نشده موجب افزایش  $Pao_2$  و متعاقباً کاهش تهویه آلوئولی میگردد و بدنبال آن بیمار دچار احتباس  $CO_2$  و آپنه می شود. کنترل پیدرپی و منظم ABG پرستار را از افزایش  $CO_2$  آگاه میکند.

۱- صدمات چشمی

صدمات شبکیه در بالغین که در معرض اکسیژن ۱۱۱٪ قرار می گیرند اتفاق می افتد. مددجویانی مبتلا به بعضی از بیماریهای شبکیه نظیر دکولمان می باشند، مستعدتر هستند. اشک ریزش، ادم، اختلال بینایی نتیجه عوارض سمی اکسیژن با غلظت بالا روی قرنيه و عدسی در بالغین است .

تجویز مقادیر زیاد اکسیژن در نوزادان نارس ممکن است موجب انقباض در عروق خونی نارس شبکیه، آسیب به سلولهای آندوتلیال، دکولمان شبکیه و بروز کوری شود. میزان صدمه بستگی به میزان  $Pao_2$  دارد بنابراین توصیه شده است که در نوزادان میزان  $Pao_2$  در سطح ۶۱ میلی مترجیوه حفظ شود.

#### ۱- آتلاکتازی جذبی

این عارضه ممکن است بعلت خارج کردن نیتروژن از آلوئولها توسط اکسیژن ایجاد شود. بطور طبیعی هوای استنشاقی حاوی حدوداً ۷۹٪ نیتروژن و ۱۱٪ اکسیژن است. نیتروژن در حالت نرمال حجم باقیمانده را که موجب باز نگه داشتن آلوئولها میشود حفظ میکند . زیرا جذب نیتروژن از غشاء آلوئولی بسیار ضعیف است. زمانی که بدنبال تجویز مقادیر بالای اکسیژن (که به راحتی از غشاء تنفسی قابل جذب است)، این گاز جایگزین نیتروژن گردد حجم باقیمانده کاهش یافته، کلاپس آلوئولی ایجاد میشود. این وضعیت بخصوص در زمانی که بیمار حجم کم و یا حجم طبیعی بدون sigh دریافت میدارد و یا دچار آمفیزم است و همراه با آن اکسیژن با غلظتهای بالا دریافت میکند، ایجاد میشود.

#### ۴- مسمومیت با اکسیژن :

در صورت مصرف اکسیژن با غلظت بیش از ۶۱٪ این عارضه بروز می کند. تغییرات پاتولوژیک ریه ها ۴۸-۱۴ ساعت پس از دادن اکسیژن با فشار بالا رخ می دهد. تجویز اکسیژن موجب کاهش فعالیت مژکهای مخاطی شده منجر به تجمع ترشحات در راههای هوایی و نهایتاً پنومونی غیرعفونی می شود. نشانه های اولیه مسمومیت با اکسیژن شامل التهاب خفیف تراشه و برونش همراه با احساس درد در پشت جناغ سینه، احتقان بینی و درد در هنگام دم و سرفه است که تدریجاً سرفه ها شدیدتر و درد پشت جناغ بیشتر شده، تنگی نفس بروز پیدا می کند. مسمومیت اکسیژن در نهایت به تخریب غشاء تنفسی و کاهش تولید سورفکتانت، آتلاکتازی پیشرونده، ادم غیرقلبی و سفت شدن و فیبروز ریه می انجامد.

ریه ها می توانند بطور طبیعی اکسیژن ۱۱٪ را تحمل کنند. اگرچه هنوز دقیقاً مشخص نیست که چه درصدی از اکسیژن میتواند موجب مسمومیت شود اما به احتمال قوی تر،  $Fio_2$  بالای ۵۱٪ برای مدت بیشتر از ۱۴ ساعت، خطر مسمومیت را افزایش میدهد . تصور میشود که عوامل ایجاد مسمومیت با اکسیژن، محصولات نهایی اکسیژن هستند که در طی واکنشهای بیوشیمیایی تشکیل می-شوند. این محصولات نهایی که رادیکالهای آزاد اکسیژن خوانده میشوند شامل پراکسیدهای پروژن، رادیکال سوپراکسید و رادیکال



هیدروکسیل هستند. مصرف طولانی غلظتهای بالای اکسیژن ممکن است موجب تشکیل رادیکالهای آزاد شده به بافت ریه صدمه بزنند

شناسایی علائم مسمومیت با اکسیژن ممکن است مشکل باشد، زیرا علائم آن درست مشابه علائم بیماریهای وخیم تنفسی است که نیاز به تجویز اکسیژن دارند. سرفه، دیسپنه در استراحت، درد پشت جناغ، تهوع و استفراغ، سردرد، بی اشتهایی و پارسازی از علائم شایع آن هستند.

جهت شناسایی بهتر این افراد باید دانست که اینها اکثراً بیمارانی هستند که دارای وضعیت خطیر بوده اینتوبه هستند .

علائم کلینیکی بعد از ۶ ساعت از تجویز اکسیژن ۱۱٪ شامل درد تیز قفسه‌سینه و سرفه خشک. بعد از ۱۸ ساعت، کاهش عملکرد ریه و بعد از ۴۸-۱۴ ساعت بروز علائم ARDS است.

ABG بهترین منبع اطلاعاتی برای جلوگیری از مسمومیت با اکسیژن است. هدف این است که  $Pao_2$  بیمار بین ۶۱ تا ۹۱ میلی‌متر جیوه حفظ شود. در صورتی که  $Pao_2$  بیمار حدود ۹۱ میلی مترجیوه و  $FIO_2$  زیر ۴۱٪ باشد، بیمار کمتر در معرض خطر مسمومیت با اکسیژن قرار دارد.

### جهت جلوگیری از بروز مسمومیت با اکسیژن رعایت موارد زیر کمک کننده است

۱- محدود کردن دوره مصرف اکسیژن ۱۱٪ به مدت‌های کوتاه (حدود ۱۱-۶ ساعت).

۱- کاهش  $Fio_2$  به پایین ترین مقدار آن در اولین فرصت ممکن با حفظ  $Pao_2$  بیشتر از ۶۱ میلی مترجیوه

۱- استفاده از اکسیژن بالای ۷۱٪ ممکن است برای ۱۴ ساعت بی خطر باشد .

۴- اکسیژن بالای ۵۱٪ ممکن است برای مدت ۱ روز بی خطر باشد.

۵-  $Fio_2$  بالای ۴۱٪ بعد از ۱ روز بالقوه سمی خواهد بود.

۶- استفاده از  $Fio_2$  زیر ۴۱٪ ندرتاً منجر به مسمومیت با اکسیژن خواهد بود.

بطور کلی، استفاده از اکسیژن با غلظت بالای ۶۱٪ برای مدت بیش از ۱۶ ساعت، و اکسیژن ۱۱٪ برای مدت بیش از ۶ ساعت منجر به بروز میکروآتلتکتازی و کلاپس آلوئولی می گردد. تنفس اکسیژن با غلظت ۱۱-۸۱٪ برای مدت ۱۴ ساعت یا بیشتر منجر به پیشرفت ARDS خواهد شد.

## روشهای تجویز اکسیژن

اکسیژن معمولاً از طریق سیلندر و یا به صورت سانترال جهت تجویز در اختیار قرار میگیرد. قبل از تجویز اکسیژن باید آن را مرطوب کرده و از نظر فشار تعدیل نمود (توسط مانومتر).

ابزارهای لازم برای اکسیژن درمانی به دو گروه عمده تقسیم می شوند: سیستمهای با جریان بالای اکسیژن (High System) Flow و سیستمهای با جریان کم اکسیژن (Low Flow System).

در سیستمهای با جریان کم اکسیژن، بیمار هوای اتاق را همراه با اکسیژن تنفس میکند. برای استفاده از این نوع سیستمها، بیمار باید حجم جاری طبیعی و الگوی تنفسی منظم داشته باشد. از این نوع سیستم میتوان از کانولای بینی Nasal Canula، ماسک ساده اکسیژن Simple Oxygen Mask، ماسک با استنشاق مجدد هوای بازدمی Rebreathing Mask با کیسه ذخیره کننده و ماسکهای بدون استنشاق مجدد هوای بازدمی Non Rebreathing Mask با کیسه ذخیره کننده نام برد.

سیستمهای با جریان زیاد اکسیژن، معمولاً درصد  $F_{iO_2}$  مشخص و ثابتی را ایجاد میکنند که با تغییر در الگوی تنفس بیمار، در آنها تغییری ایجاد نمیشود. شایعترین و متداولترین مثال آن ماسک ونچوری است.

## سیستمهای تجویز اکسیژن با جریان کم

این دستگاهها اکسیژن را با غلظتهای متفاوتی از ۹۱-۱۱ درصد به بیمار تحویل میدهند. در این سیستمها متغیرهایی که روی  $F_{iO_2}$  (درصد اکسیژن هوای دم) تاثیر میگذارد عبارتند از:

۱- ظرفیت ذخیره ای آناتومیکی دستگاه تنفس (حجم حلق بینی، حلق دهانی و...)

۱- نوع سیستم تجویز اکسیژن (سوند یا کانولای بینی، ماسک، کیسه ذخیره ساز).

۱- میزان جریان اکسیژن (لیتر در دقیقه)

۴- الگوی تهویه بیمار (در بیمارانی که تنفس عمیق دارند، درصد اکسیژن کمتری به بیمار می رسد، زیرا مقدار زیادتری از هوای اتمسفر که دارای  $F_{iO_2}$  برابر ۰.۱۱ است با اکسیژن تجویز شده مخلوط می گردد و  $F_{iO_2}$  را پایین می آورد).

### ۱- کانولای بینی یا سوند بینی Nasal Cannula Or Catheter

این وسیله متداولترین ابزار برای تجویز اکسیژن است و بوسیله آنها با تجویز ۶-۱ لیتر اکسیژن در دقیقه می توان  $Fio_2$  به میزان ۴۴- ۱۴ درصد به بیمار برساند. هنگام استفاده از این ابزار باید سوراخهای بینی باز و تنفس از طریق بینی امکان پذیر باشد.

برحسب سرعت تجویز اکسیژن، مقدار تقریبی  $Fio_2$  هوای دمی به قرار زیر است:

مقدار اکسیژن	$Fio_2$
۲ لیتر در دقیقه	28-24%
۱ لیتر در دقیقه	32-28%
۴ لیتر در دقیقه	36-32%
۵ لیتر در دقیقه	40-36%
۶ لیتر در دقیقه	44-40%

### مزایا

استفاده آسان، تحمل خوب توسط بیمار، تحرک بیشتر، عدم قطع اکسیژن حین فعالیتهایی چون سرفه، صحبت کردن، غذاخوردن، خوردن دارو....

### معایب

غلظت اکسیژن داده شده را نمی توان دقیقاً کنترل کرد و بستگی به حجم جاری و ریت تنفسی دارد. میزان جریان اکسیژن تجویز شده نباید از ۶ لیتر در دقیقه تجاوز نماید زیرا موجب تحریک، خشکی و آزدگی مخاط بینی میشود. مقدار زیادی از اکسیژن از طریق بینی و دهان خارج میشود. کاتترهای بینی ندرتاً برای تجویز اکسیژن به مدت طولانی استفاده می شود زیرا با این روش ممکن است مخاط حلق دهانی دچار تحریک و آزدگی شود. هنگام استفاده از کاتربینی، درصد اکسیژنی که به ریه ها میرسد به عمق و سرعت تنفس بستگی دارد (بخصوص در حضور تورم مخاط بینی یا عادت به تنفس با دهان).



## ۲- ماسک ساده صورت Simple Mask

برای غلظتهای پایین تا متوسط اکسیژن از این وسیله استفاده نمیشود (۴-۱ لیتر در دقیقه). با تجویز اکسیژن با سرعت ۶-۱۱ لیتر در دقیقه میتوان  $F_{iO_2}$  به میزان ۴۱-۶۱٪ ایجاد کرد. در بیمارانی که با دهان تنفس میکنند تجویز اکسیژن با این روش موثرتر از کانولای بینی است. برحسب سرعت تجویز اکسیژن، مقدار تقریبی  $F_{iO_2}$  هوای دمی به قرار زیر است:

مقدار اکسیژن	$F_{iO_2}$
۵ لیتر در دقیقه	٪۴۱
۶ لیتر در دقیقه	٪۴۵-۵۱
۸ لیتر در دقیقه	٪۵۵-۶۱

این ماسکها باید کاملاً با بینی و دهان تماس شود، لیکن نباید به صورت فشار وارد آورد و باعث قطع جریان خون شود. جریان اکسیژن معمولاً باید به میزان ۵ لیتر در دقیقه یا بیشتر تنظیم شود تا از تجمع هوای بازدمی در زیر ماسک و استنشاق مجدد آن که حاوی دی اکسید کربن بالاست اجتناب گردد.

**مزایا:** تجویز  $F_{iO_2}$  بالا

**معایب:** غالباً توسط بیماران تحمل نمی شود (بخصوص در افرادی که دچار دیسپنه شدید و صدمه و سوختگی در صورت هستند). در هنگام بعضی فعالیتها نظیر خوردن، سرفه، خروج خلط و ... جریان اکسیژن باید قطع شود.



### ۳- ماسک ذخیره کننده اکسیژن

مانند ماسک ساده صورت هستند که یک کیسه ذخیره کننده اکسیژن دارند. دو نوع ماسک ذخیره کننده وجود دارد:

#### الف) ماسکهای با استنشاق مجدد بخشی از هوای بازدمی Partial Rebreathing Mask

این ماسکها با تجویز اکسیژن به میزان ۱۱-۱۶ لیتر در دقیقه،  $F_{iO_2}$  در حدود ۸۱-۶۱٪ را ایجاد می کنند. این نوع ماسک دارای کیسه ذخیره سازی بوده، ذخیره مصنوعی اکسیژن را افزایش می دهد و در نتیجه  $F_{iO_2}$  بیشتری به بیمار می رساند. تقریباً یک سوم از هوای بازدمی نیز به کیسه ذخیره کننده باز میگردد که در واقع حجم برگشتی از فضای مرده آناتومیک است که هنوز غنی از اکسیژن است، گرم و مرطوب بوده و حاوی مقدار کمی دی اکسید کربن است. جهت اطمینان از اینکه بیمار حجم زیادی از هوای بازدمی را مجدداً تنفس

نمی کند، باید جریان اکسیژن حداقل ۶ لیتر در دقیقه باشد. به نحوی که با هر دم بیش از یک سوم از حجم کیسه ذخیره ساز کاسته شود. در غیر اینصورت دیاکسیدکربن نیز میتواند در کیسه ذخیره ساز تجمع یابد و موجب افت درصد اکسیژن داخل کیسه گردد.



ب) ماسکهای بدون استنشاق مجدد هوای بازدمی Non Rebreathing Mask

این ماسکها دارای کیسه ذخیره ساز با دریچه یکطرفه هستند که اجازه ورود هوای بازدمی به داخل کیسه ذخیره ساز را نمیدهد . بوسیله این ماسکها با تجویز ۱۵-۶ لیتر اکسیژن در دقیقه، می توان  $F_{iO_2}$  به میزان ۱۱۱-۹۵٪ ایجاد کرد. در این نوع ماسک باید کیسه را در مدت دم مورد مشاهده قرار داد. کیسه نباید با هر بار تنفس بیش از یک سوم از گنجایش خود جمع شود. اگر سرعت جریان اکسیژن ۱۵-۶ لیتر در دقیقه باشد، میتوان مطمئن بود که کیسه پر باقی میماند.



#### ۴-چادر صورت Face Tent

چادر صورت روش دیگری جهت تجویز اکسیژن در سیستم با جریان آهسته اکسیژن است. مزیت مهم این دستگاه آن است که میتوان رطوبت زیادی را همراه با آن به مددجو رساند. از معایب آن نیز این است که نمی توان  $F_{iO_2}$  را دقیقاً کنترل کرد. با این وسیله، توسط تجویز ۴-۸ لیتر در دقیقه اکسیژن،  $F_{iO_2}$  در حدود ۴۱٪ فراهم می گردد.



### ۵- چادر اکسیژن Oxygen Tent

این وسیله بیشتر در اطفال که قادر به تحمل ماسک و کانولای بینی نیستند استفاده می شود. شرایط استفاده از چادر اکسیژن عبارتند از:

۱- کنترل درجه حرارت چادر) در صورتی که اکسیژن گرم تجویز شود، درجه حرارت چادر آنقدر بالا می رود که موجب تعریق می گردد

به این ترتیب مصرف اکسیژن بدن بالا می رود.)

۱- کنترل رطوبت چادر

۱- کنترل از نظر افزایش دی اکسید کربن زیر چادر) چادر باید تهویه داشته باشد.)



۴- استریلیتی چادر) چادر باید بعد از هر بار مصرف ضد عفونی شود.



#### ۶- T-Piece یا T-Tube

این وسیله روی لوله تراشه قرار میگیرد و از طریق آن اکسیژن با فشار بالا به بیمار داده میشود. این ابزار میتواند علاوه بر تجویز اکسیژن، توسط مقاومتی که در سر راه بازدم ایجاد میکند، سبب تولید حدود ۵ سانتیمتر آب PEEP شود و از افزایش  $Paco_2$  جلوگیری نماید. میزان جریان مخلوط هوا و اکسیژن درون T-Piece باید ۵.۱ برابر حجم دقیقه‌های باشد.

#### ۷- تجویز اکسیژن از طریق ترانس تراکیال

در این روش از طریق جراحی یک کاتتر کوچک از محل غشاء کریکوتیروئید به داخل تراشه وارد و مستقیماً جریان اکسیژن به داخل تراشه برقرار میگردد. استفاده از این روش موجب کاهش مصرف اکسیژن بخصوص در مواردی میشود که بطور مزمین نیاز به اکسیژن درمانی در منزل با کپسول یا بصورت پرتابل وجود داشته باشد. با این روش می توان  $Fio_2$  را به میزان ۱۱ تا ۵۱ درصد افزایش داد. بایستی به بیمار و خانواده در مورد نحوه مراقبت از تراکتوستومی و چگونگی تعویض کاتتر آموزش داده شود.


## ب) سیستم‌های با جریان بالای اکسیژن High Flow System

### ماسک ونچوری Venturi Mask

ماسک‌های ونچوری جهت تجویز اکسیژن با جریان بالا استفاده می‌شوند. این ماسک‌ها قابل اعتمادترین و دقیقترین روش برای تجویز غلظت صحیح و کنترل شده اکسیژن هستند. این وسایل طوری طراحی شده‌اند که هوای اتاق را با جریان ثابتی از اکسیژن مخلوط کرده سپس به ریه‌ها می‌فرستند. به علت سرعت بالای جریان گاز در این سیستم، همواره میزان ثابتی از اکسیژن در سیستم جریان داشته، هوای اضافی همراه با دیاکسید کربن بوسیله این جریان سریع از زیر ماسک خارج می‌شود.

در این نوع ماسک انواع ماسک آداپتورهای قابل تعویضی وجود دارد که مقدار ثابتی از اکسیژن را با حجم ثابتی از هوا مخلوط کرده به بیمار می‌رساند:

رنگ آداپتور	Fio2	O2
آبی	٪۱۴	۴ لیتر در دقیقه
زرد	٪۱۸	۴ لیتر در دقیقه
سفید	٪۱۱	۶ لیتر در دقیقه
سبز	٪۱۵	۸ لیتر در دقیقه
صورتی	٪۴۱	۸ لیتر در دقیقه

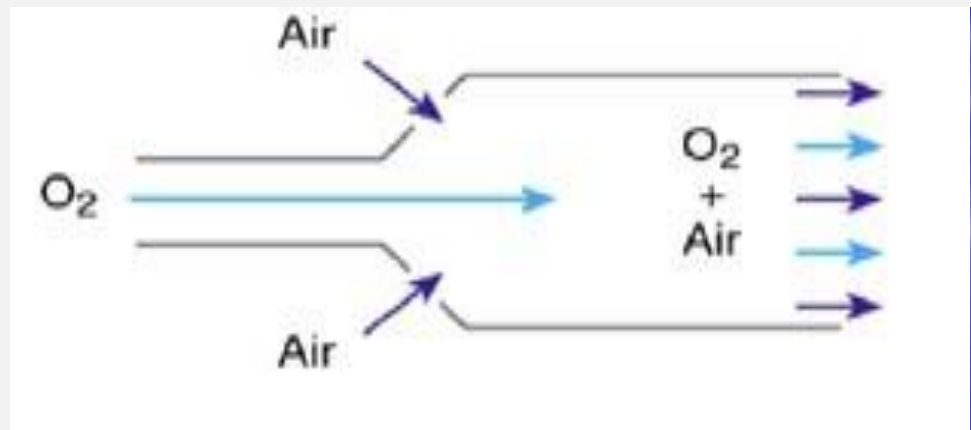



مهمترین مورد مصرف ماسک ونچوری در بیماریهای مزمن انسدادی ریه COPD است.

## نکات لازم در به کارگیری سیستمهای سریع تحویل اکسیژن

- ۱- در زمان صرف غذا آنها را به نزال کانولا تغییر دهید.
- ۱- در طی عمل دم و بازدم به پخش شدن آئروسول از دریچه های سیستم توجه کنید.
- ۱- به منظور تامین اکسیژناسیون کافی باید رسوب از لوله ها زدوده شود.
- ۴- از میزان آب کافی در ظرف اطمینان حاصل کنید. در صورت نیاز آب ظرف آئروسلها را تعویض نمایید.
- ۵- بخش بازدمی (سوراخ بازدمی) را در زمان استفاده از T-piece باز بگذارید در غیر این صورت احتمال خفگی وجود خواهد داشت.
- ۶- به گونه ای تی پیس را تثبیت کنید که سبب کشیدگی لوله داخل تراشه و تراکتوستومی نشده و خراش پوستی به وجود نیارد.
- ۷- اطمینان حاصل نمائید که رطوبت موجود بخار کافی ایجاد می کند. در طی عمل دم و بازدم باید بخار مشاهده گردد.

## دستگاه پالس اکسی متر

در بدن انسان بطور مداوم فعالیتهای متابولیک برای ادامه حیات صورت میگیرد. فعالیت متابولیک با مصرف کسیتزن و تولید دی-اکسیدکربن و انرژی همراه است. بدون وجود اکسیتزن تولید انرژی ناچیز است (متابولیسم بیهوازی)، به علاوه در متابولیسم بیهوازی اسید لاکتیک تولید میشود که میتواند در تعادل اسید و باز بدن اختلال ایجاد کند. ضمناً دفع آن از بدن به مراتب مشکلتر از دفع دیاکسیدکربن است. برای انجام اعمال متابولیک و برای حفظ حیات، باید اکسیتزن از هوا به ریهها و سپس به داخل خون وارد شود و توسط جریان خون به بافتها برسد. در نتیجه اطلاع از میزان اکسیتزن خون یکی از پارامترهای حیاتی در تشخیص و درمان بسیاری از بیماریها و آسیبهای بافتی است.

از رایجترین سیستمهای اندازهگیری میزان اکسیتزن خون، میتوان به آنالیزور گازهای خون، CO اکسیمتر و پالساکسی متر اشاره کرد. آنالیزور گازهای خون به صورت Invitor میزان  $po_2$  را اندازهگیری میکند. Co اکسی متر نیز به صورت Invitor میزان  $sao_2$  در صد اشباع اکسیتزن شریانی (را اندازهگیری میکند. مزیت این دو روش دقت بالای آنهاست و معایب آنها در تهاجمی بودن و اندازهگیری غیرهمزمان) offline است. در صورتیکه سیستم پالساکسیمتر به صورت online و غیر تهاجمی تخمین مناسبی از درصد اشباع خون  $spo_2$  را محاسبه میکند. از همین رو این سیستم کاربرد کلینیکی وسیعی در مانیتورینگ میزان اکسیتزن خون بیمار پیدا کردهاست.

## اندازهگیری Sao2

رایجترین شیوه اندازهگیری درصد اشباع اکسیتزن خون تکنیک نوری است، که از خواص نوری خون جهت محاسبه Sao2 استفاده می-کند. زمانی که خون اکسیژندار میشود، به رنگ قرمز در آمده و زمانی که اکسیتزن آن مصرف میشود، به رنگ آبی تیره در میآید. این ویژگی نشانگر تغییر میزان جذب نور در اثر تغییر میزان اکسیتزن است. بخش عمده گلبولهای قرمز را ترکیبات مختلف هموگلوبین تشکیل میدهد، و ۹۹٪ هموگلوبین خون شامل هموگلوبین باند نشده (Hb) و اکسیهموگلوبین (Hbo2) است.

به سه طریق میتوان میزان Sao2 را محاسبه کرد:

### ۱- روش آزمایشگاهی Invitro

در این روش نمونه خون بیمار در معرض مستقیم تابش نور قرار داده می شود و با آنالیز شدت نور عبوری می توان Sao2 را محاسبه کرد. مزیت این روش دقت بالا و عیب آن Offline بودن و تهاجمی بودن آن است.

## ۲- روش تهاجمی (کا تتر)

در این روش یک فیبر نوری در کا تتر مناسب قرار می گیرد و به داخل شریان فرستاده می شود و از این طریق نور بطور مستقیم به خون تا بیده می شود. پرتو نور پس از عبور از فاصله معین، مجدداً از طریق فیبر نوری در یافت شده و به خارج از بدن منتقل می شود. پس از اندازه گیری شدت نور منتقل شده میزان  $SaO_2$  محاسبه می شود.

## ۳- روش غیر تهاجمی

در روش غیر تهاجمی، بخشهایی از بدن که ضخامت کمتری دارند (لاله گوش، انگشت و...) برای ارسال و دریافت اشعه نور استفاده میشوند. مشکل اصلی در این روش جذب و تفرق نور توسط سایر بافتها از جمله پوست، خون مویرگی و سیاهرگی، استخوان و... است. جهت غلبه بر این مشکل میتوان از خاصیت پالسی (ضربانی) بودن جریان خون و تغییر حجم خون در طول سیستول یا دیاستول قلبی استفاده کرد، که این ویژگی یکی از ایدههای اصلی دستگاههای پالساکسیمتر است.

دستگاه پالساکسیمتر برای سنجش و نمایش درصد اشباع اکسیژن در خون به صورت غیر تهاجمی (بدون ورود حسگر یا الکتروود به داخل بدن) به کار میرود.

در این دستگاه از تغییر ضریب جذب خون در اثر تغییر میزان اکسیژن اشباع شده استفاده می شود.

## کلید واژگان

Hypoxia	هیپوکسی
Hypoxemia	هیپوکسمی
Carbominohemoglobin	کربومینوهموگلوبین
Hypoventilation	هیپوونتیلیاسیون
Absorption atelectasis	آتلکتازی جذبی
Partial Rebreathing Mask	ماسکهای با استنشاق مجدد بخشی از هوای بازدمی
Non Rebreathing Mask	ماسکهای بدون استنشاق مجدد هوای بازدمی
Deoxyhemoglobin	هموگلوبین احیا شده